



Placera elektroderna exakt
på det sätt som framgår av bilderna.


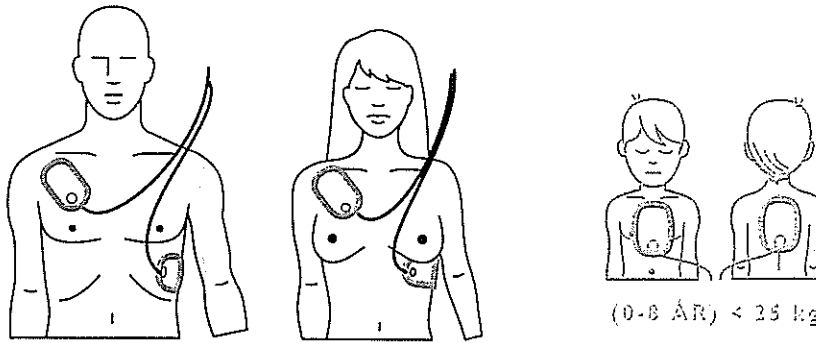


Analyserar ... Rör inte patienten!


Vänta tills  slutar blinka

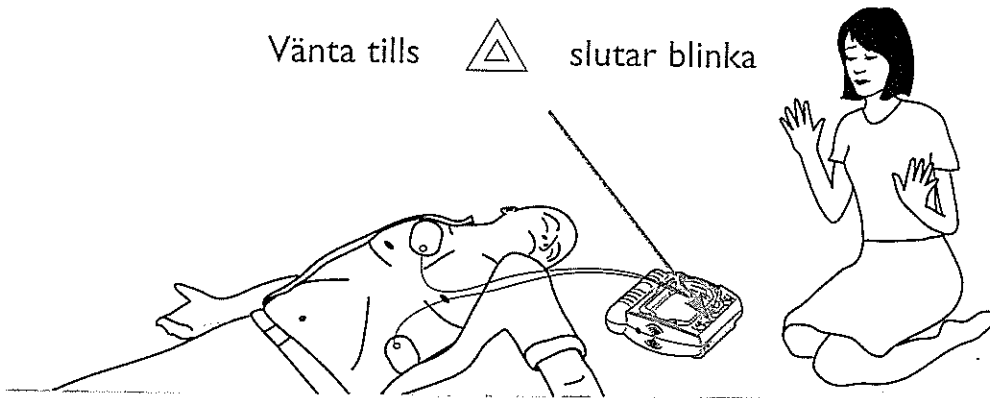

Avge en stöt: Tryck på den blinkande **ORANGE**
defibrilleringsknappen. Rör inte patienten.



7

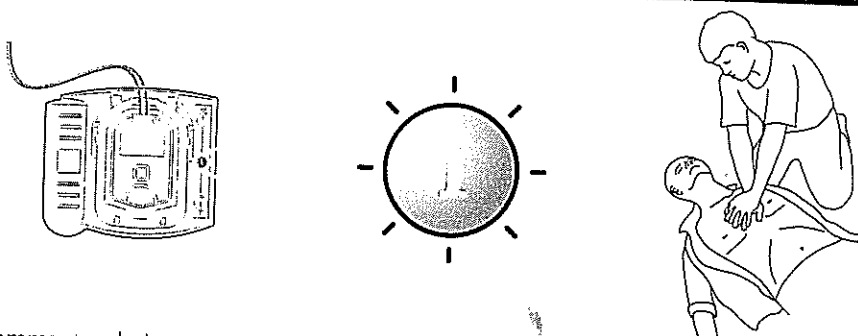

30 sammantryckningar • håll för näsan och luta huvudet bakåt • 2 kompletta andetag